
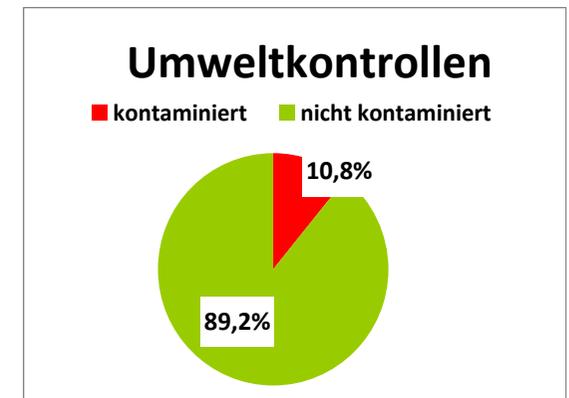


Kontamination von Ultraschallsonden nach automatisierter und manueller Desinfektion im Vergleich

Automatisierte Desinfektion durch trophon® EPR reduziert die Kontamination auf Ultraschallköpfen und -handgriffen mit deutlich höherer Wirksamkeit gegenüber Wischtüchern. Eine extrem hohe Kontamination ist auf den Handgriffen zu messen, da diese bei der manuellen Aufbereitung nicht desinfiziert werden.

(Universitätsklinikum Münster, Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe)

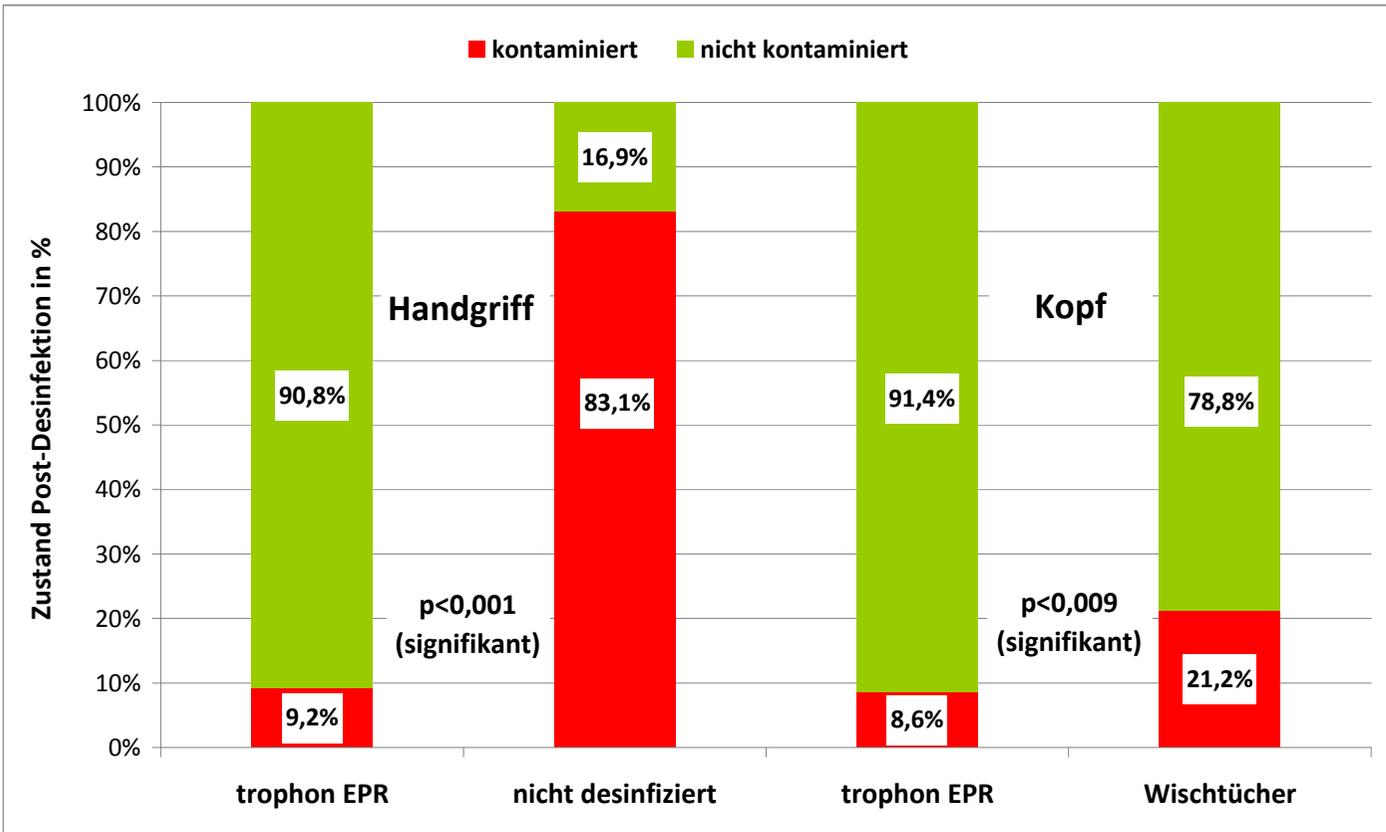

Disinfection of transvaginal ultrasound probes in a clinical setting – comparative performance of automated and manual reprocessing methods.

In: Ultrasound Obstet Gynecol.

2015 Oct 1.

doi: 10.1002/uog.15771.